


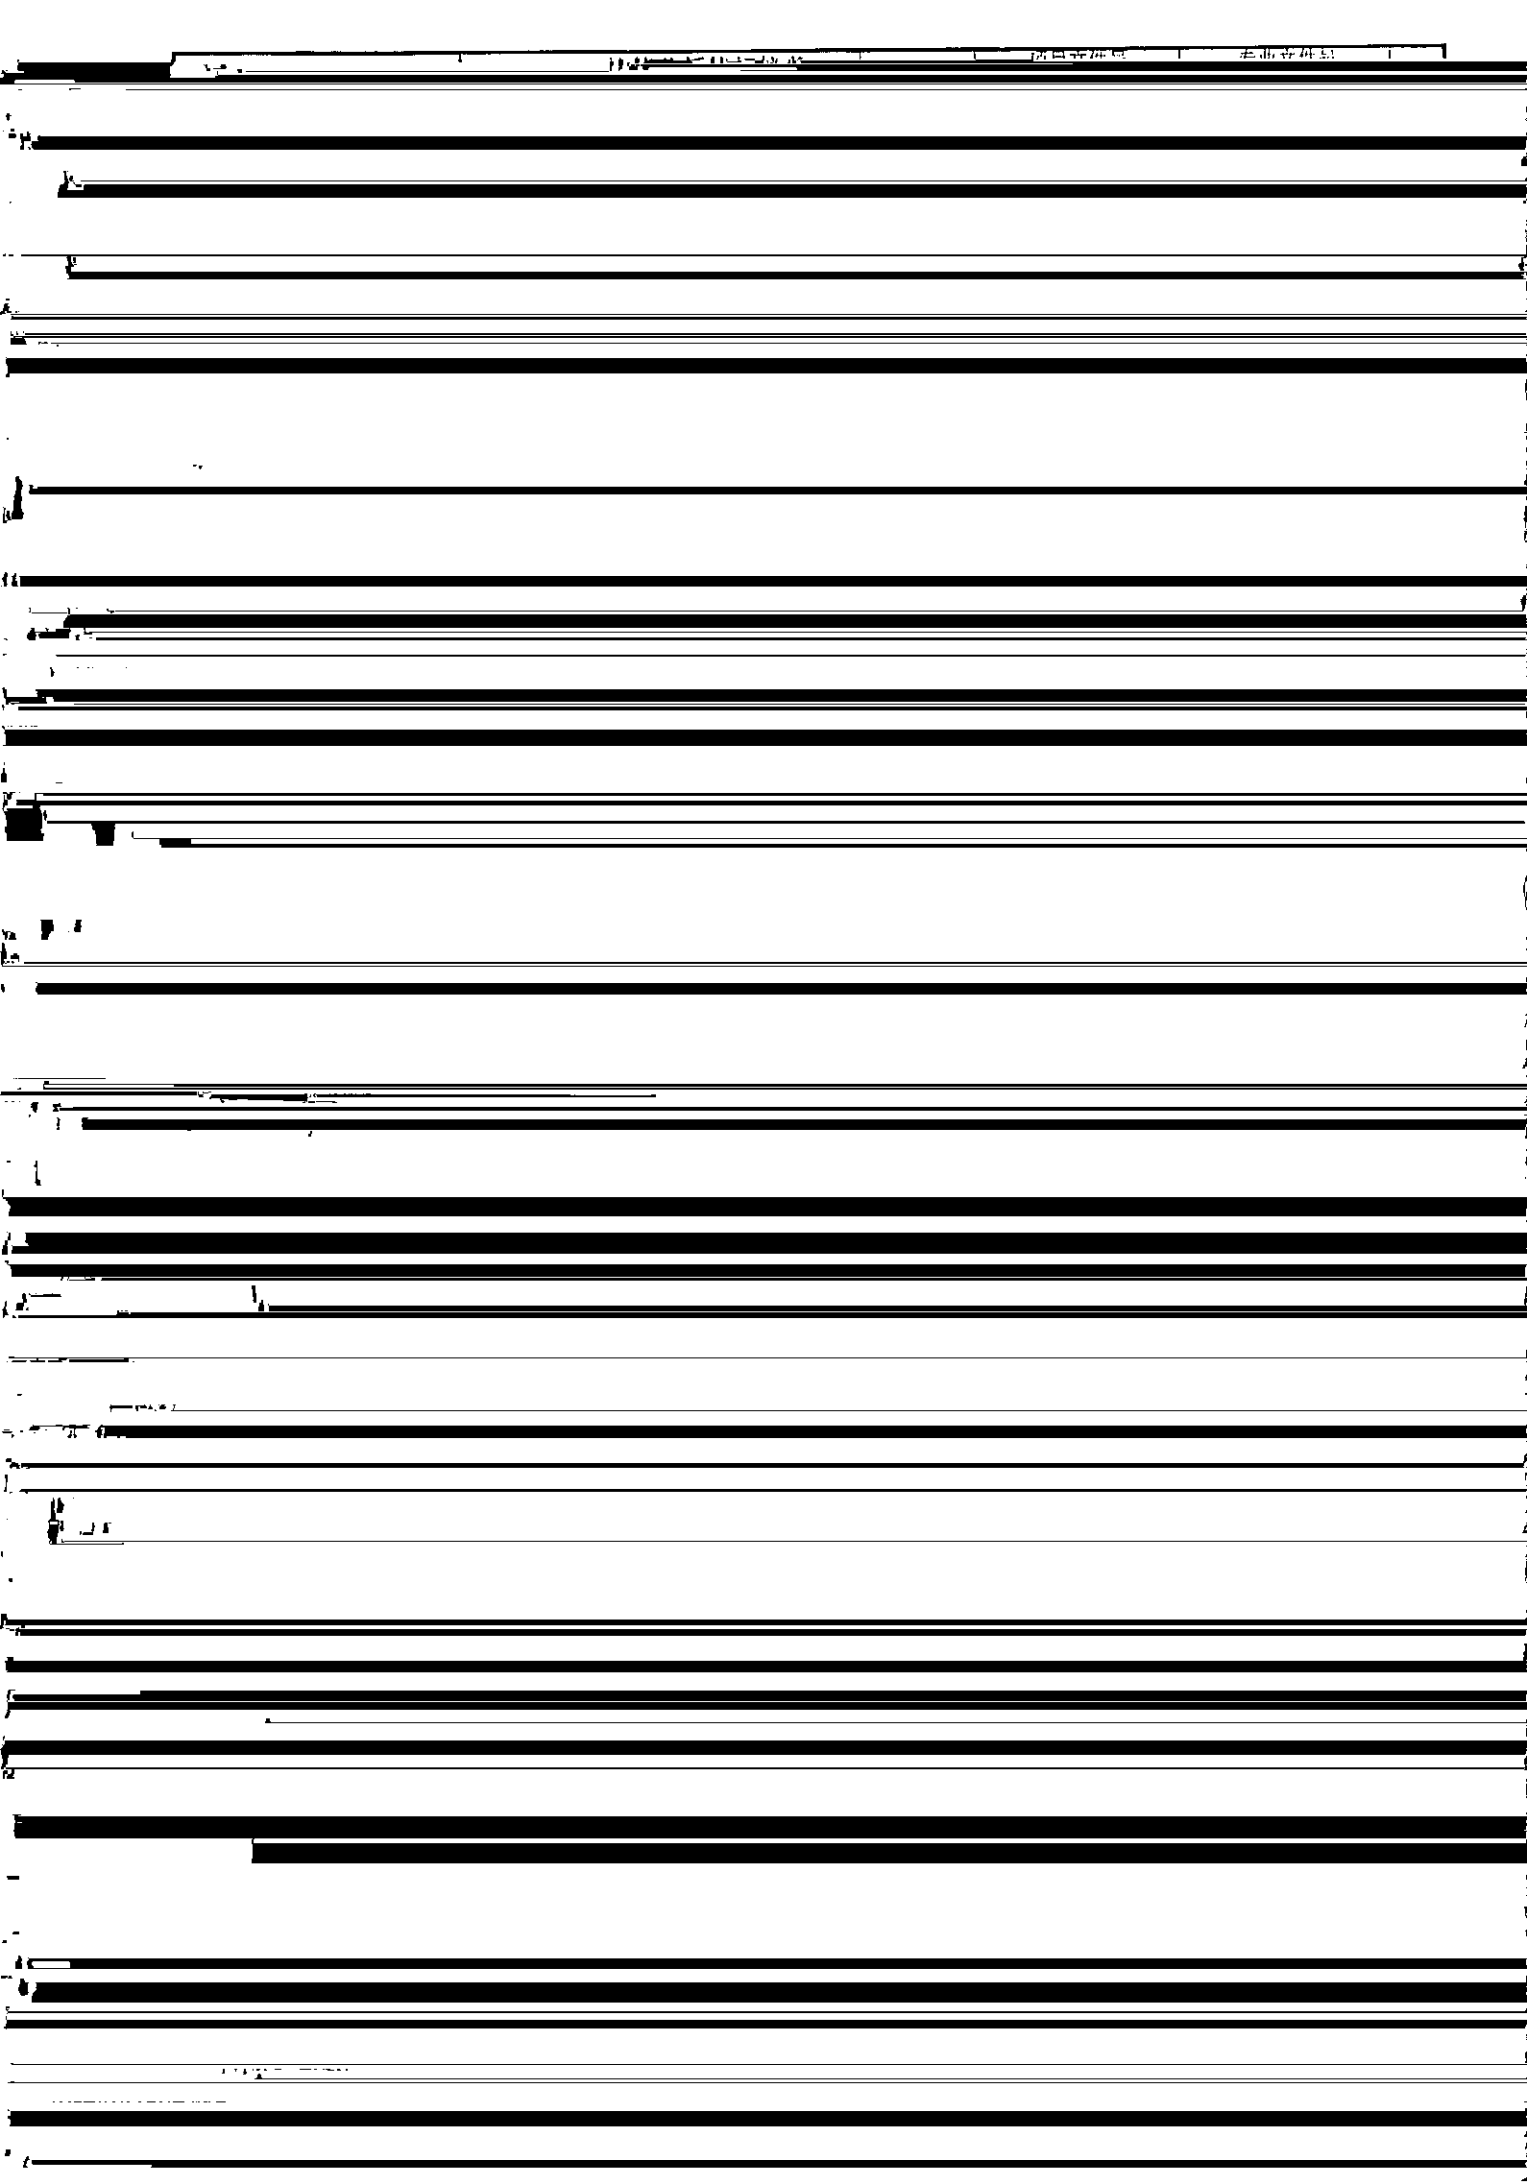

 LPEC 中国石化集团 洛阳石油化工工程公司 LUOYANG PETROCHEMICAL ENGINEERING CORP./SINOPEC	H₂S/SO₂比值分析仪规格书 H₂S/SO₂比值ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION		项目文件号 Proj. Doc. No.	专业文件号 Discipline Doc. No.	Rev.
		LPEC's	413091D2256	50-00/R507	
		顾客要求 Client's			
					第 3 页 共 3 页 Page 3 of 3

防爆等级: **ExdIICT4**
 防护等级: IP65
 电气连接: 1/2NPT(8个)
 标定方式: 内置光学自动标定
 安装方式: 分析柜内成套安装
 材质要求: 所有与分析介质接触的部件材质均为316SS
 其它要求: 在国内同类装置中至少有五家以上用户、五年以上成功使用经验.

7. 公用工程条件

电源 220Vac±10%, 50HZ±10%
 仪表风 0.6-0.8 MPa(G) 常温
 氮气 0.45 MPa(G) 155℃