


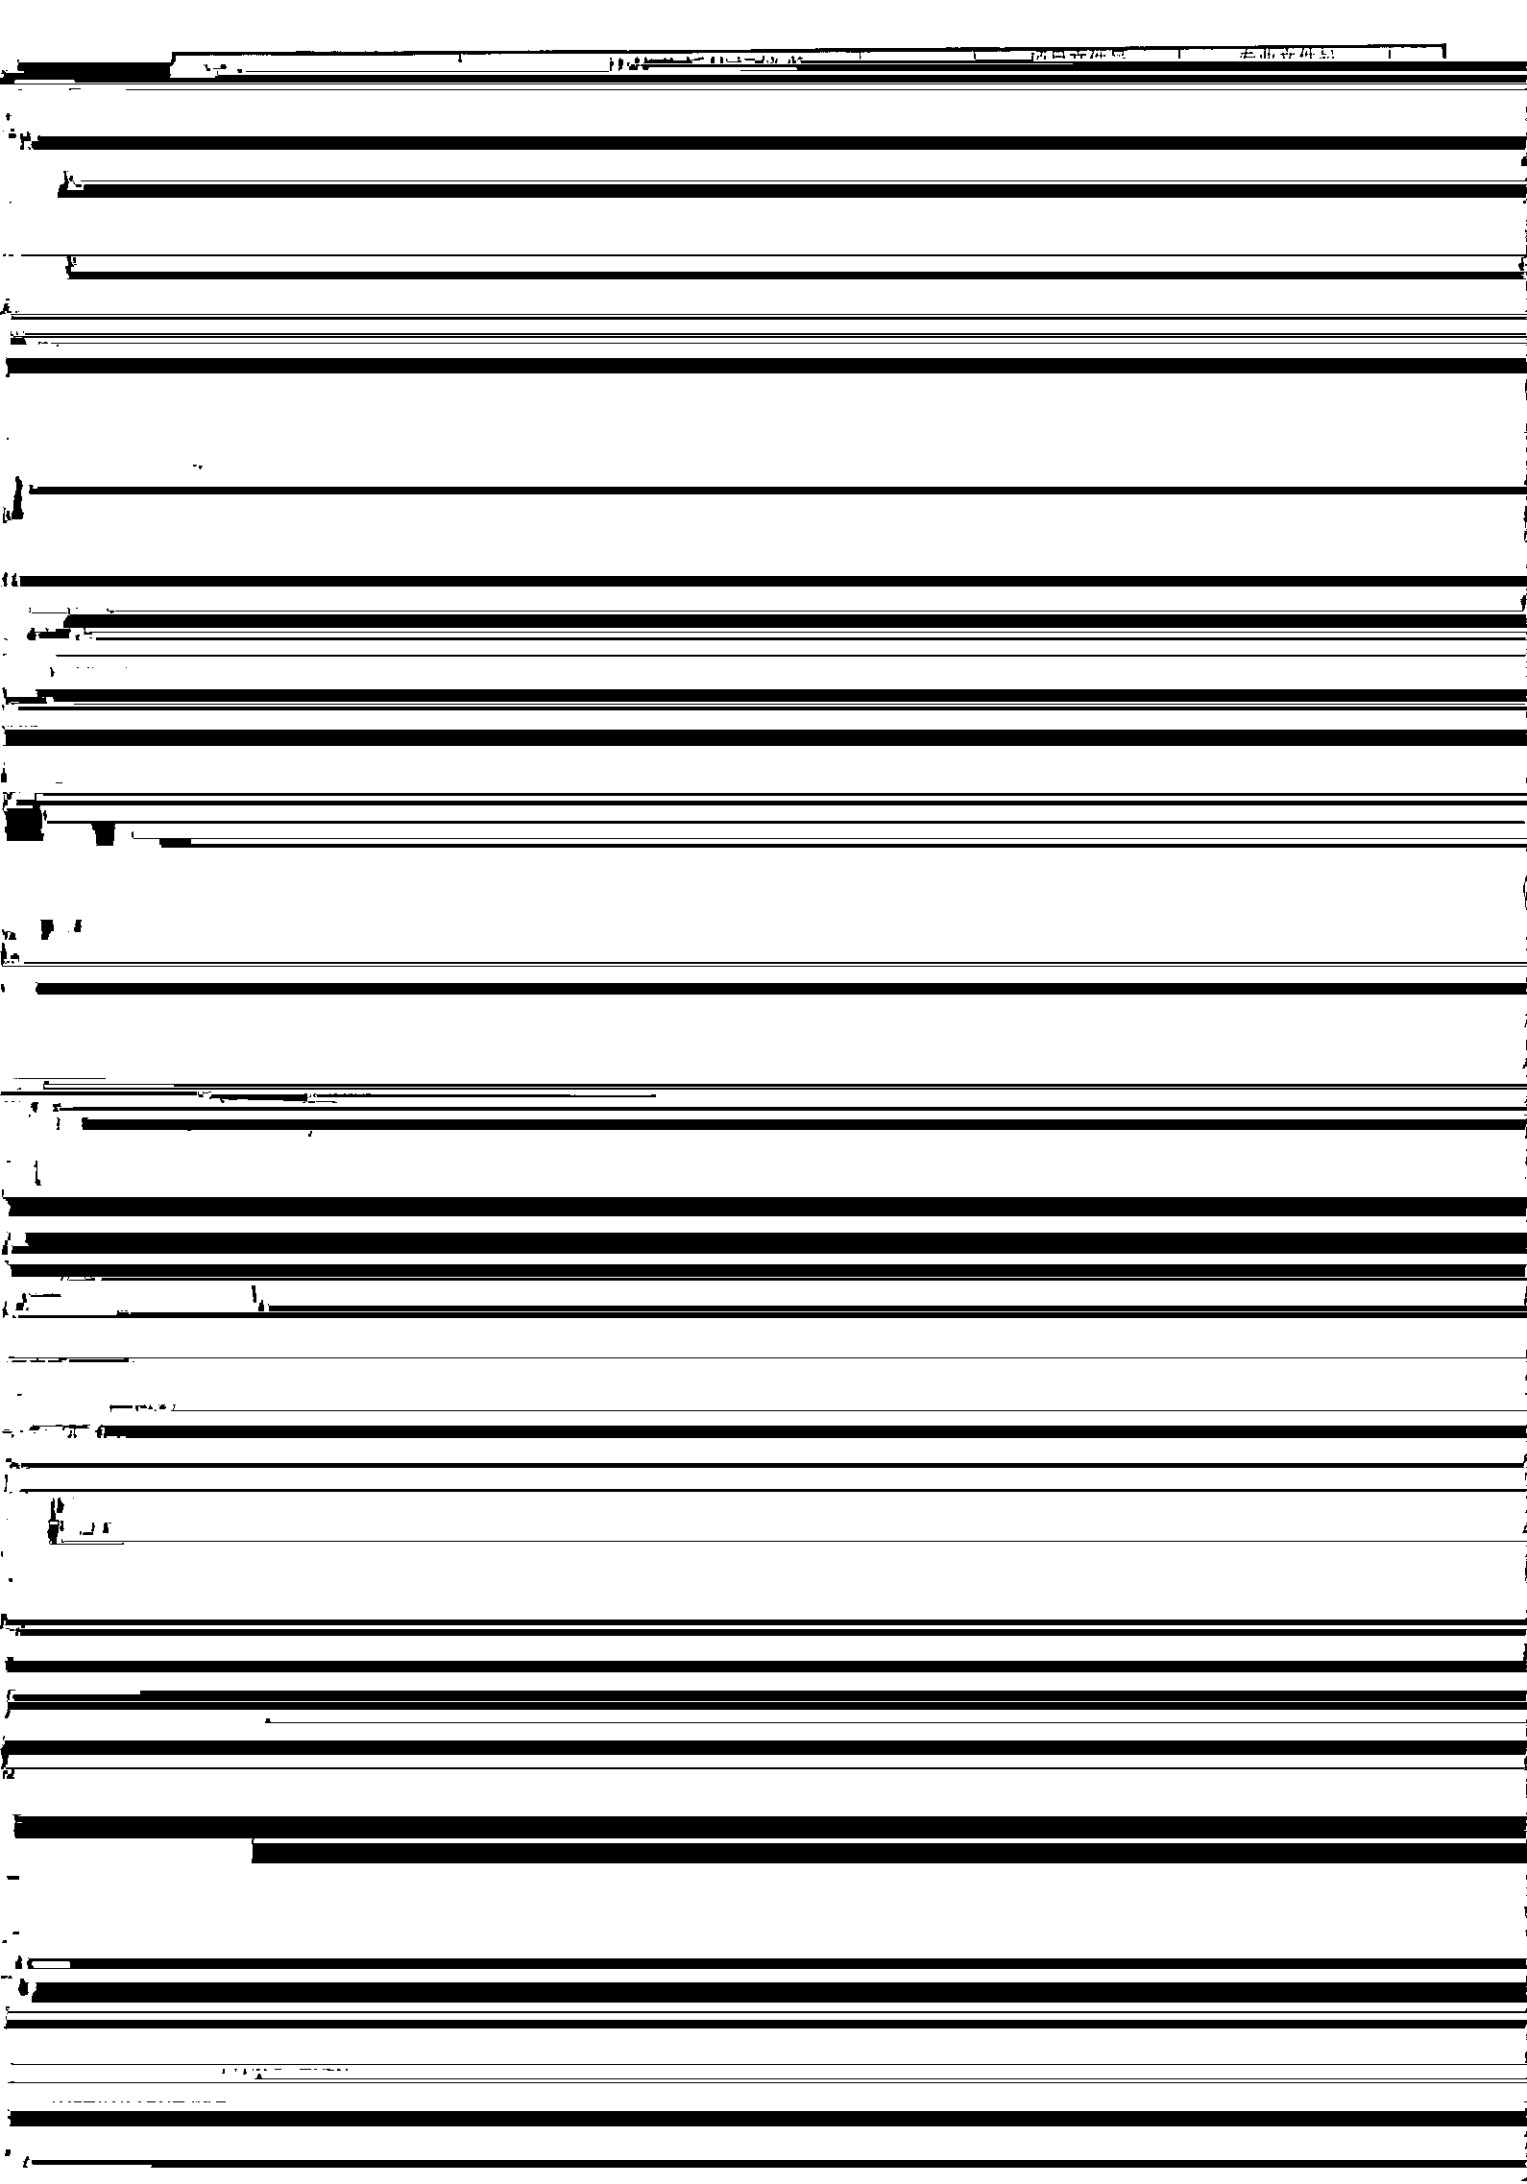

 LPEC 中国石化集团 洛阳石油化工工程公司 LUOYANG PETROCHEMICAL ENGINEERING CORP./SINOPEC	H₂S/SO₂比值分析仪规格书 H₂S/SO₂比值ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION		项目文件号 Proj. Doc. No.	专业文件号 Discipline Doc. No.	Rev.
		LPEC's	413091D2256	50-00/R507	
		顾客要求 Client's			
					第 3 页 共 3 页 Page 3 of 3

防爆等级:

ExdIICT4

防护等级:

IP65

电气连接:

1/2NPT(8个)

标定方式:

内置光学自动标定

安装方式:

分析柜内成套安装

材质要求:

所有与分析介质接触的部件材质均为316SS

其它要求:

在国内同类装置中至少有五家以上用户、五年以上成功使用经验.

7. 公用工程条件

电源

220Vac±10%, 50HZ±10%

仪表风

0.6-0.8 MPa(G) 常温

冷却水

0.45 MPa(G) 15-30℃